



消化管内有泡性ガス除去剤

バロス消泡液 300mL 包装変更のお知らせ

謹啓 平素は弊社製品につき格別のお引立てを賜り有難く厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では消化管X線検査・胃内視鏡検査に広くご愛用いただいております「バロス消泡液」につきまして、品質安定性をより向上させるため容器全体にシュリンクフィルムをかけ、遮光性を強く致しました。

つきましては、今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具


記

■変更品目

| 統一商品コード | 品 名 | 包 装 | 元 梱 | JANコード |
|---------|--------|------------------|-----|---------------|
| 602373 | バロス消泡液 | 300mL (ポリ瓶入り) | 20 | 4987320602373 |

※統一商品コード、価格等の変更はございません。

■変更内容

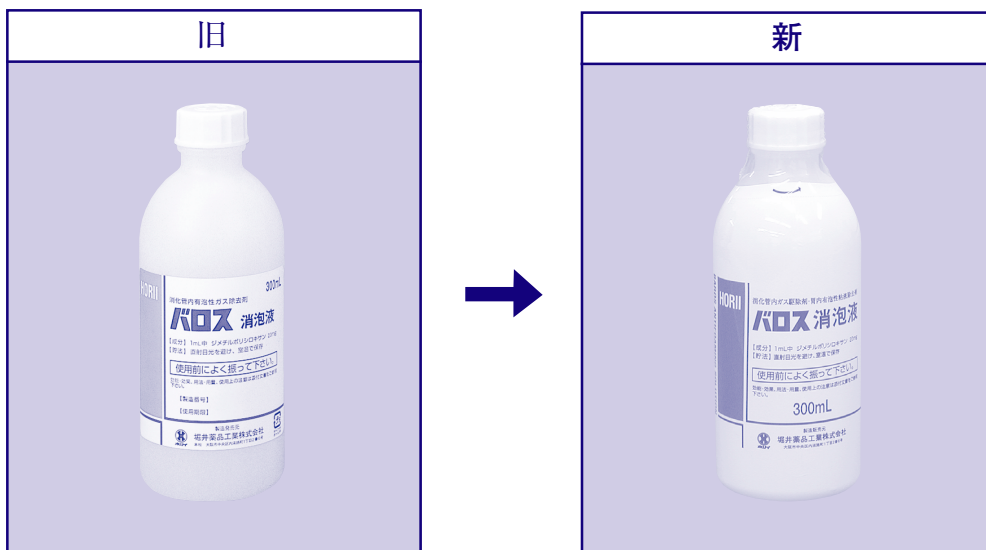

■実施製造番号 Y64211～

■出荷予定日 平成18年12月初旬
※出荷時期は地域により多少異なりますのでご了承願います。